




Emitir Laudo de Aferição de Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é emitir o laudo da aferição de hidrômetro efetuada AQUI. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de Sistema, no caminho: GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Emitir Laudo de Aferição de Hidrômetro.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

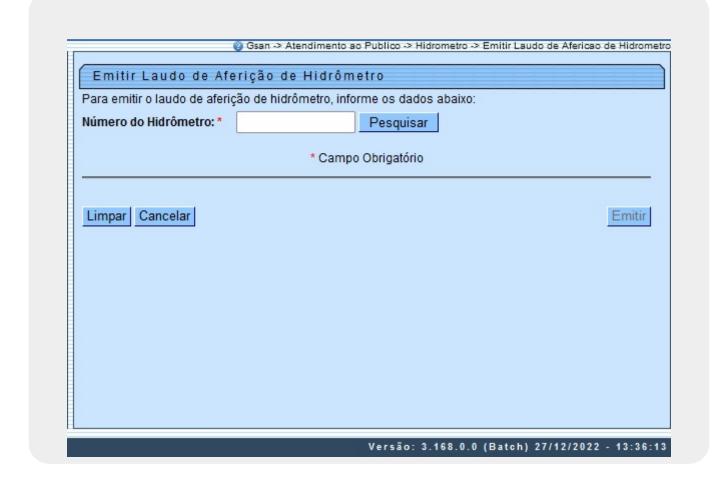

Acima, informe o número do hidrômetro com no máximo doze caracteres, incluindo dígitos e letras. Feito isso, clique em Pesquisar . O sistema seleciona a aferição mais recente para o hidrômetro informado:



para emitir o laudo de aferição do Agora, confirme os dados da aferição e clique em hidrômetro informado

Laudo de Aferição

https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/12/2025 00:21

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA LAUDO DE AFERIÇÃO HIDRÔMETRO

PAG 1 / 1 27/12/2022 14:49:39

Informo a V.S.a, que foi aferido por esta Companhia o Hidrômetro abaixo qualificado:

DADOS DO IMÓVEL		
Matrícula Imóvel: 3883356	Inscrição do Imóvel: 109.00 .230.0106.000	

DADOS DO HIDRÔMETRO		
Número: Y15N367115	Marca: ELSTER	Capacidade: 1,5 M3/HORA
Diâmetro: 1/2 POL	Tipo: MULT MAGNETICO	Classe/Range:B

DADOS DO ENSAIO			
Registro de Atendimento: 96553040	Ordem de	Serviço: 45920169	
Serviço Solicitado: AFERIC HID OFIC INF 20 M3		Bancada de Ensaio: Bancada Nº 02	
Setor Responsável pela Aferição: OFICINA DE HIDROMETRO BORBOREMA			
Validador: GSAN ADMIN		Matrícula:admin	Dt. Execução:20/12/2022

	DADOS DA AFERIÇÃO					
MEDIÇÕES DA BANCADA		MEDIÇÕES DO HIDRÔMETRO			PORTARIA 155 DE 30 DE MARÇO DE 2022 REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (INMETRO)	
Q (Vazão	em 1/h)	VOLUME ESCOADO (m³)	LEITURA INICIAL (m³)	LEITURA FINAL (m³)	ERRO(%)	ERRO ADMISSÍVEL INMETRO(%)
Q3/Qn	44,35	50,00	12,00	60,00	-4,00	-5,00 a 5,00
Q2/Qt	5,00	50,00	12,00	60,10	-3,80	-5,00 a 5,00
Q1/Qmin	5,50	44,00	5,65	50,00	0,80	-10,00 a 10,00

RESULTADO

HIDROMETRO APROVADO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

Av. Feliciano Cirne, 220 - Jaguaribe - João Pessoa - PB - CEP 58015-570

CNPJ: 09.123.654/0001-87 / Inscrição Estadual: 160572029

www.cagepa.pb.gov.br

IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito deste documento.

Você poderá verificar a autenticidade do Laudo de Aferição do Hidrômetro emitido, na nossa loja virtual Link: https://agenciavirtual.cagepa.pb.gov.br/gsan/exibirInformacoesPortalCagepaAction.do

Autenticação Eletrônica: W6T420221220



Emitido o laudo, é possível validá-lo informando o número de sua autenticação eletrônica **AQUI**. Ou pelo QR Code do laudo, caso esteja acessando a **Loja Virtual** direto de um celular.

Preenchimento dos Campos

	Orientações para Preenchimento	
Número do Hidrômetro	Campo obrigatório. Informe o número do hidrômetro com no máximo doze caracteres, incluindo dígitos e letras.	
	caracteres, incluindo dígitos e letras.	

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade		
Pesquisar	Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa a aferição mais recente para o hidrômetro informado.		
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.		
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.		
Emitir	Ao clicar neste botão, o sistema emite o laudo de aferição do hidrômetro.		

Referências

Emitir Laudo de Aferição de Hidrômetro

Termos Principais

Hidrômetro

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.



From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:emitir_laudo_de_afericao_de_hidrometro&rev=1672239408

Last update: 28/12/2022 14:56



https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/12/2025 00:21